

直接、准确、快速的蛋白质 pI 点测定：分析时间小于 10 分钟，测定准确而且重复性出色（见图 1-1 和图 1-2），常规方法难以与其相比拟。

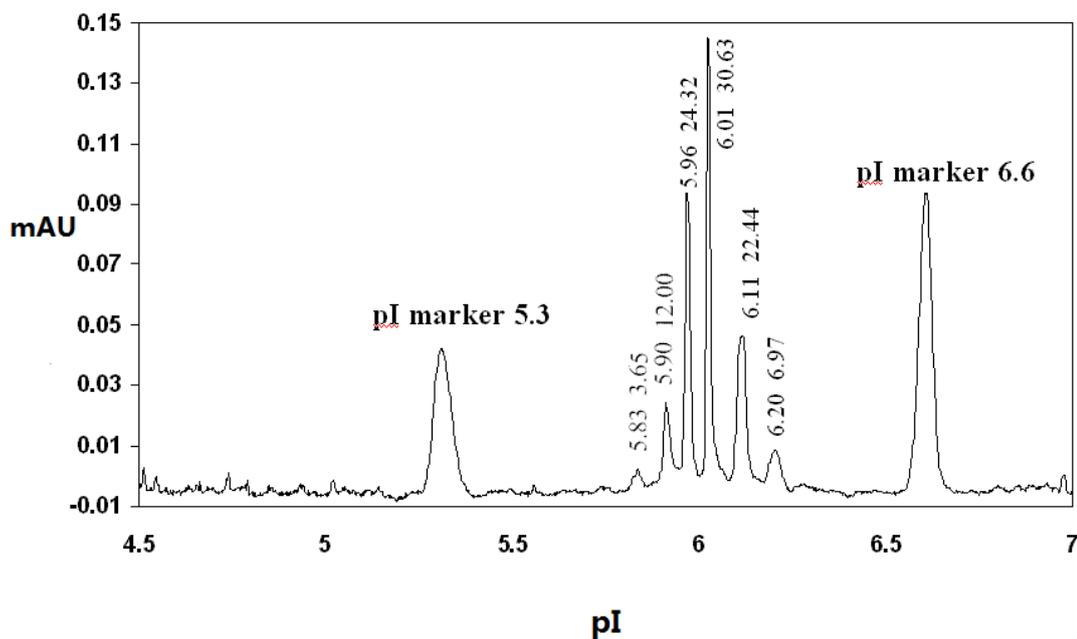


图 1-1: 蛋白质药物 pI 点的准确测定（均一性研究）

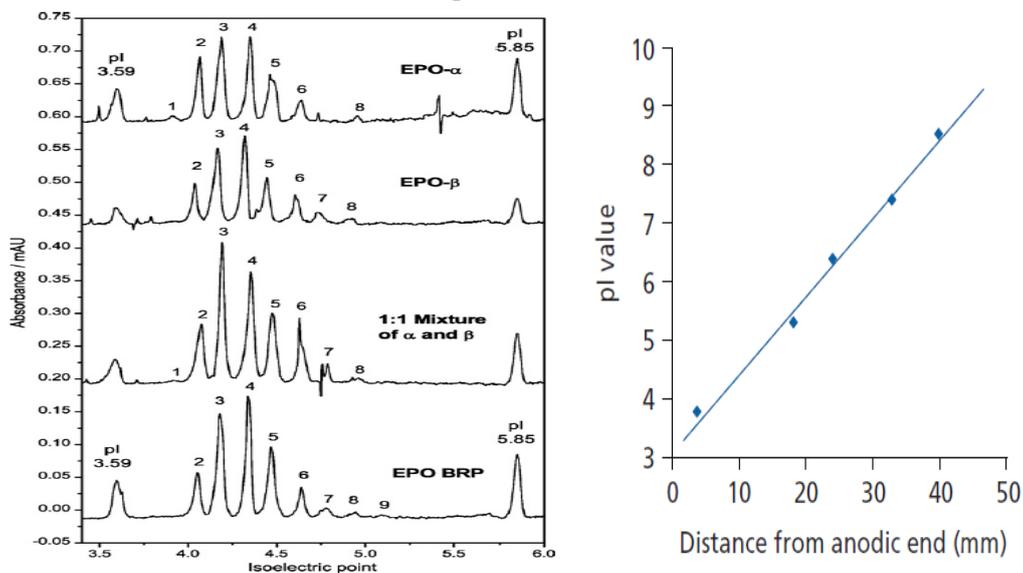


图 1-2: 不同来源 EPO 的 pI 点测定（多肽类兴奋剂的检测）